

Renishaw Analysis- 2012: CTC


QFR100定位补偿后

操作员: a hao

机器名称 机器 序列号
被测轴 C 运行次数 2 Alternate bidir

目标 13 Pilgrim
测试日期 星期四 2024/12/26 07:15 下午

注释 :

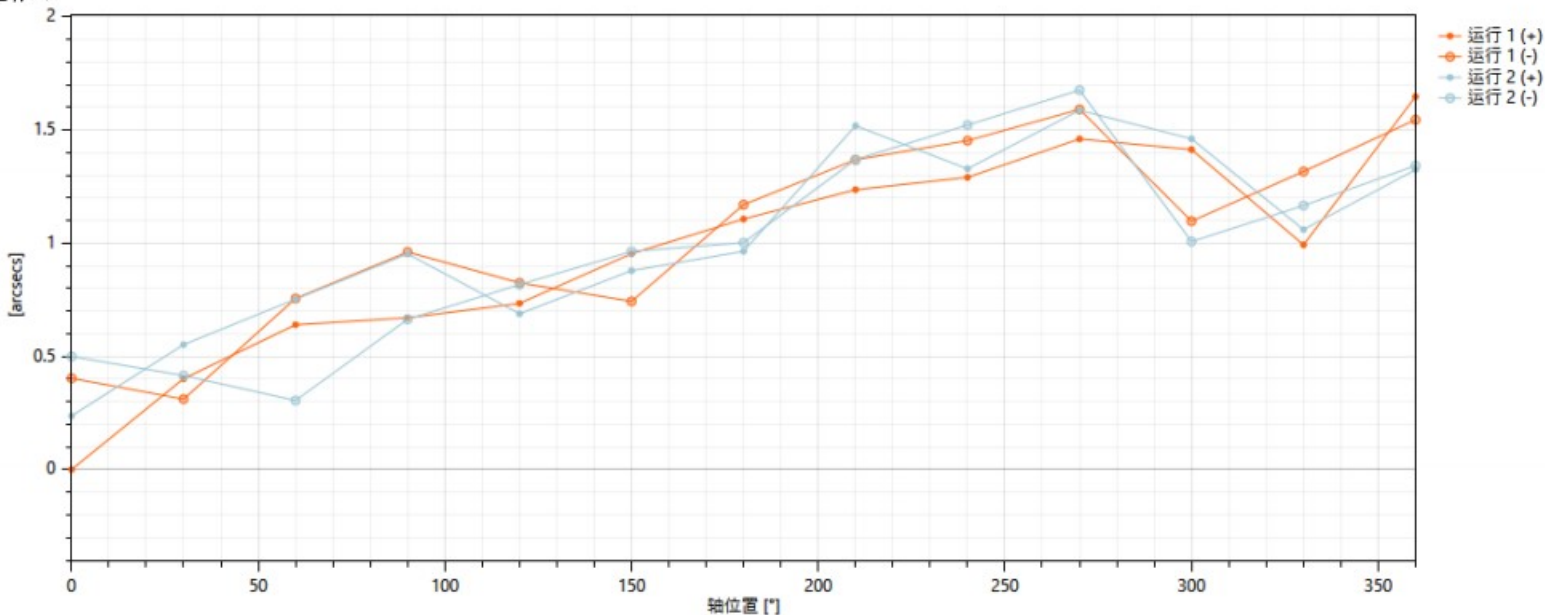

CTC - 分析功能

名称	值 (arcsecs)
定位精度 (A)	1.7
重复精度 (+)	0.3
重复精度 (-)	0.5
双向重复精度	0.5

环境条件

名称	开始	终点	最小值	最大值
膨胀系数 [ppm/° C]	11.70			